



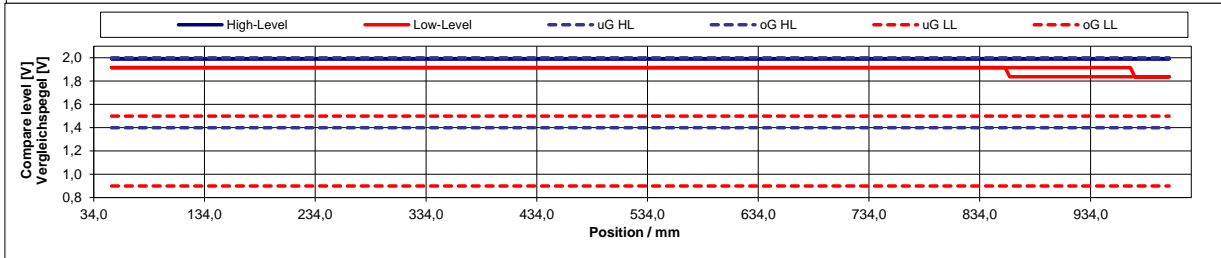



FLM / BLM (FFG-T / FFG-BT) Calibration Certificate

Ser.-No.: / Ger.-Nr.: 38205
 Measured length: / Verfahren: 955 mm
 Increment: / Schrittweite: 4 mm
 Test result: / Gesamtergebnis: OK

Order No.: / Auftrags-Nr.: 2031981
 Probe type: / Sondentyp: Ex XTS B NT
 Probe length: / Sondenlänge: 1075 mm
 Production date: / Produktions Datum: 06.12.2024



Regression line: 0,30585 Gradient: 1,0001 => Failure: 0,14284 mm/m
 Regressionsgerade: 0,30585 Steigung: 1,0001 => Fehler: 0,14284 mm/m Axis intercept: -0,0790 mm

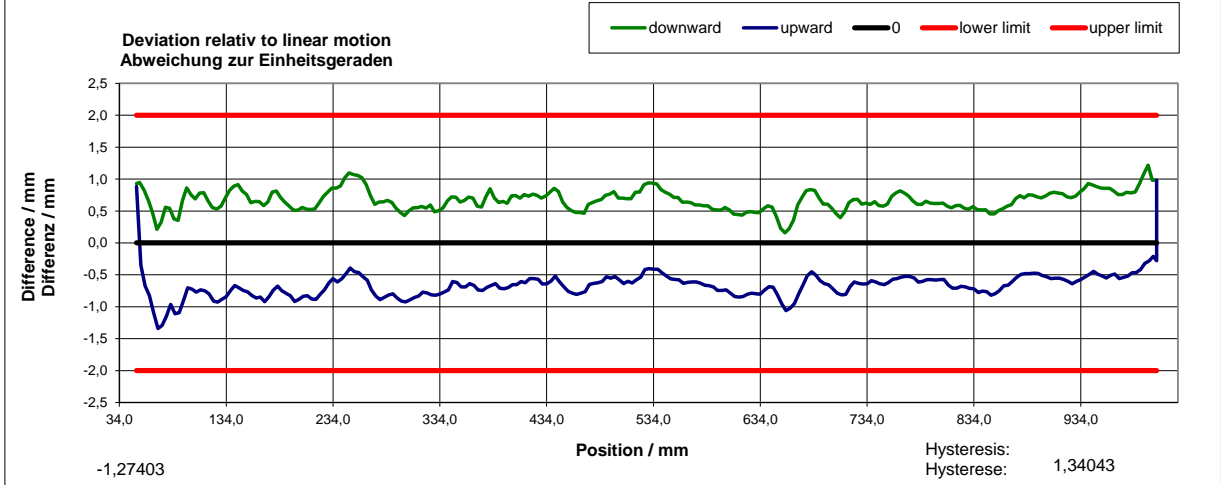

Variance T: 0,02 °C Average error: -0,18 °C Adjustment: 0,09 m/s
 Varianz T: 0,02 °C Mittlerer Meßfehler: -0,18 °C Korrektur: 0,09 m/s

